



1 20°Vブロック

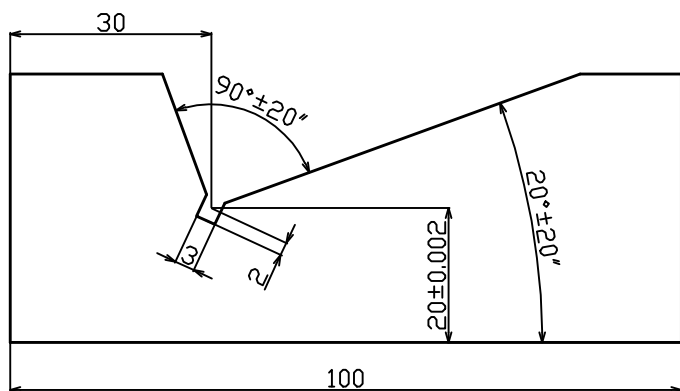

数量

1


2 30°Vブロック

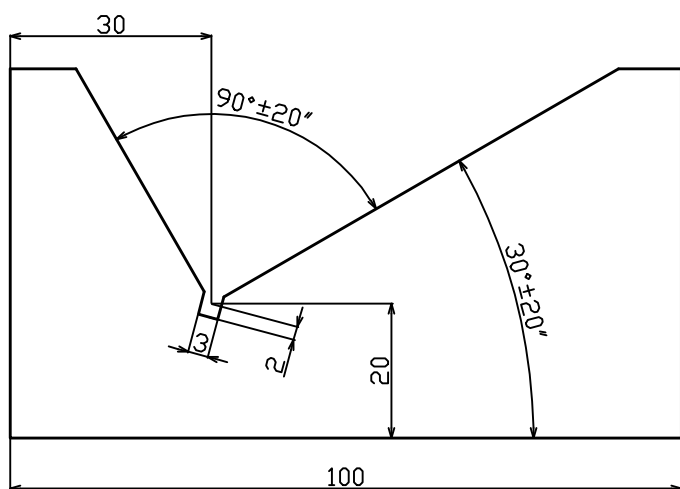

数量

1

3 1/20°Vブロック

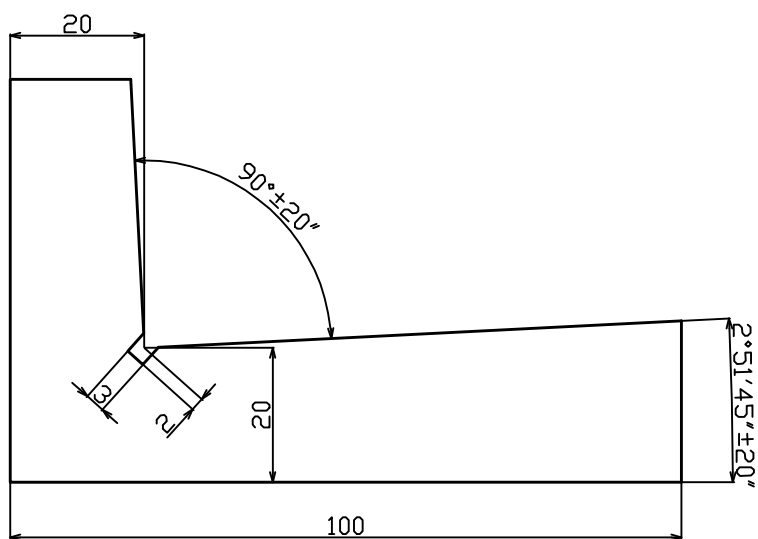


数量

1


測定工具図面

4 検査用プラグゲージ

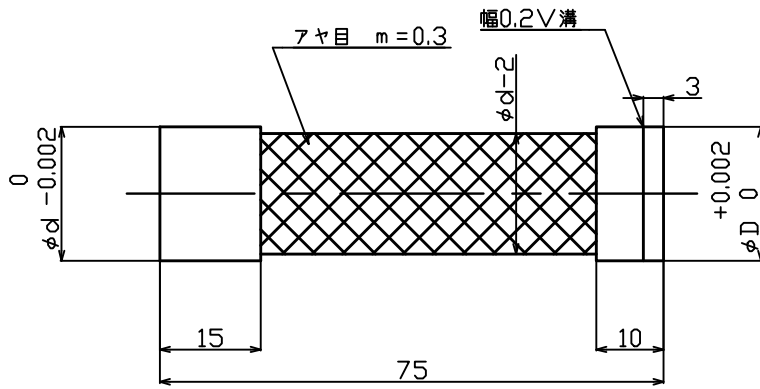


NO	φd	φD	数量
1	12	12.018	1
2	14	14.018	1
3	20	20.021	1
4	30	30.021	1

5 マンドレル

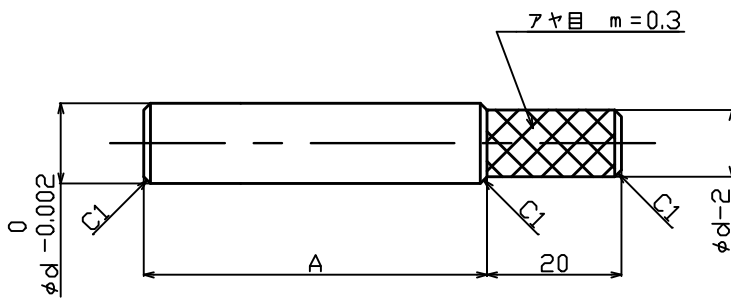

NO	A	φd	数量
1	100	11.989	1
2	70	13.989	1


6 R溝専用ゲージ

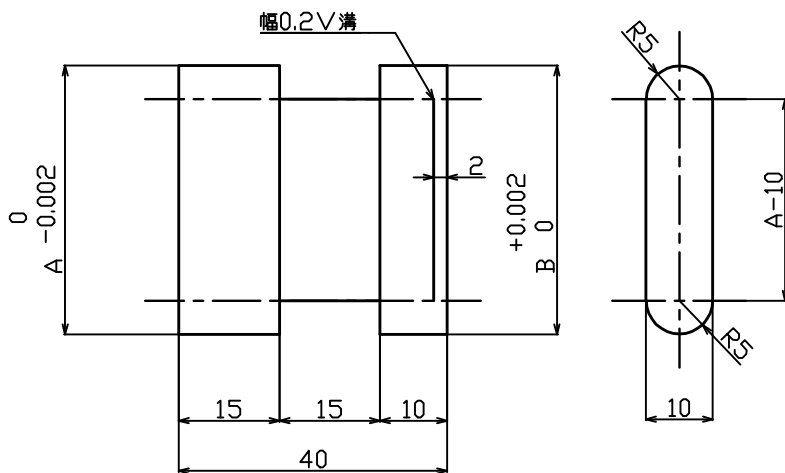

NO	A	B	数量
1	19.280	19.310	1
2	27.015	27.045	1
3	33.284	33.314	1
4	34.000	34.030	1


測定工具図面

7 NO・GOゲージ

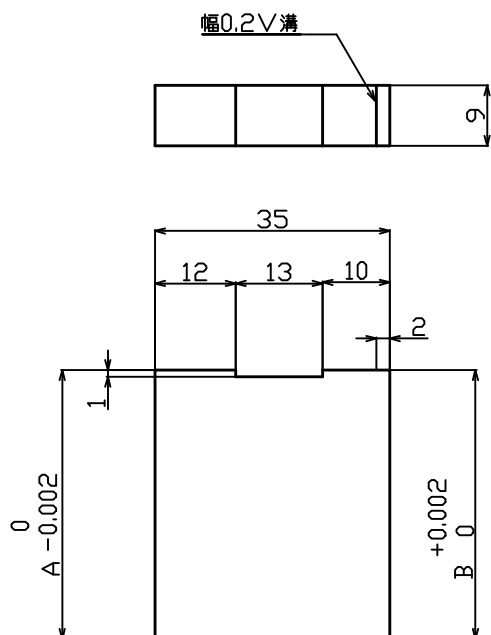

NO	A	B	数量
1	10.000	10.020	1
2	12.000	12.030	1
3	14.000	14.030	1
4	14.845	14.875	1
5	32.000	32.020	1
6	34.000	34.020	1
7	37.000	37.020	1
8	60.000	60.020	1
9	70.000	70.020	1


8 専用ブロック

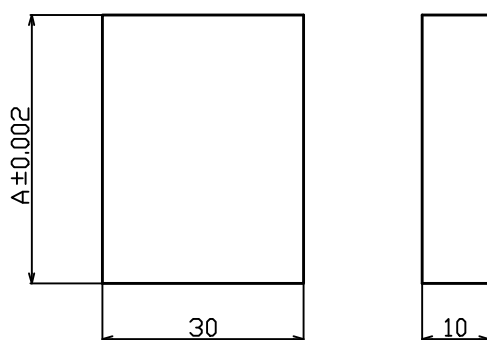

NO	A	数量
1	2.196	1
2	12.359	1
3	21.280	1
4	25.577	1
5	37.423	1
6	41.889	1
7	63.196	1
8	66.480	1
9	67.280	1

測定工具図面


9 Rゲージ

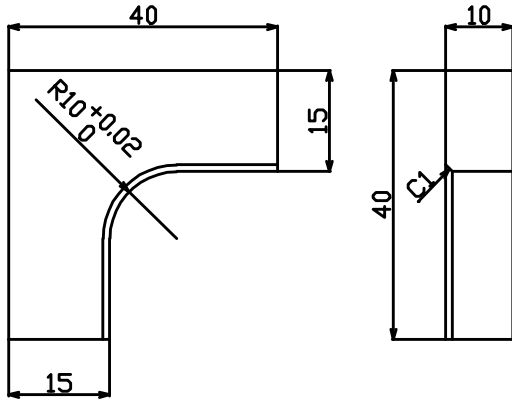

数量

2


10 測定コロ

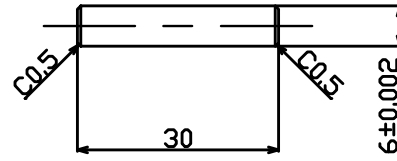

数量

8


11 組立てスキマゲージ

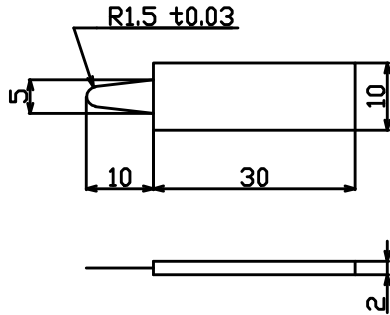

数量

2

12 R部スキマゲージ

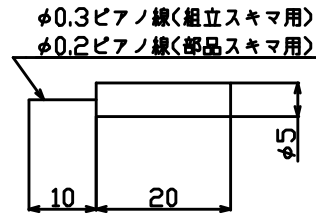

数量

各2